

R FAB







REGISTRO ANVISA 80009860008
www.barrfab.com.br
S02407
SN 427088270 LOT 10135782
440204 - ANGULAR ACO INOX # MODELO: B # TAMPO DORSO BIPAR
REF BARRFAB
Barrfab Ind. Com. Imp. e Exp.
de Equipamentos Hospitalares Lda

BARRFAB
REF 200 - MESA CIRURGICA BF683 MOTORIZADA ST
440204 - ANGULAR ACO INOX # MODELO: B # TAMPO DORSO BIPAR
SN 0172890724 LOT 10135782
2024/07
www.barrfab.com.br
REGISTRO ANVISA 80009860008




X693

HMP Hospital Memorial de Pernambuco
PATRIMONIO 000869





JAB
COMPUTADORES

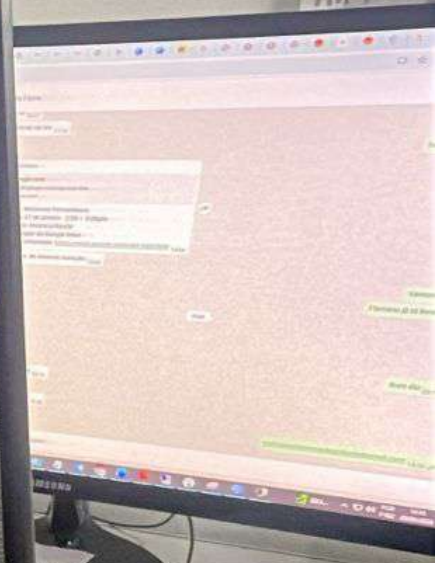

HMP Hospital de Pernambuco
PATRIMÔNIO 000887



Modelo: MR-19
Alimentação: 100-240VAC



AVISO: Alta tensão! Para evitar choque elétrico, não abra a placa traseira por conta própria. Se precisar de alguma inspeção, entre em contato com profissionais ou assistência autorizada!

MONITOR LED 19 PQL HR-19 CATECH
11243131405301000598



CATECH

FCCE
INDUSTRIA BRASILEIRA

Modelo: MR-19

Alimentação: DC 12V/2.5A


C3TECH



AVISO: Alta tensão! Para evitar choque elétrico, não abra a placa traseira por conta própria! Se precisar de alguma inspeção, entre em contato com profissionais ou assistência autorizada!



MONITOR LED 19 PDL MR-19 C3TECH



243131406801000863

FC CE
INDÚSTRIA BRASILEIRA

HMP
000878







Modelo: **MR-19**
Alimentação: 100-240VAC



AVISO: Alta tensão! Para evitar choque elétrico, não abra a placa traseira por conta própria! Se precisar de alguma inspeção, entre em contato com profissionais ou assistência autorizada!



FCCE
INDUSTRIA BRASILEIRA

MONITOR LED 19 POL MR-19 CATECH







11243131405301000755



HMP
000890



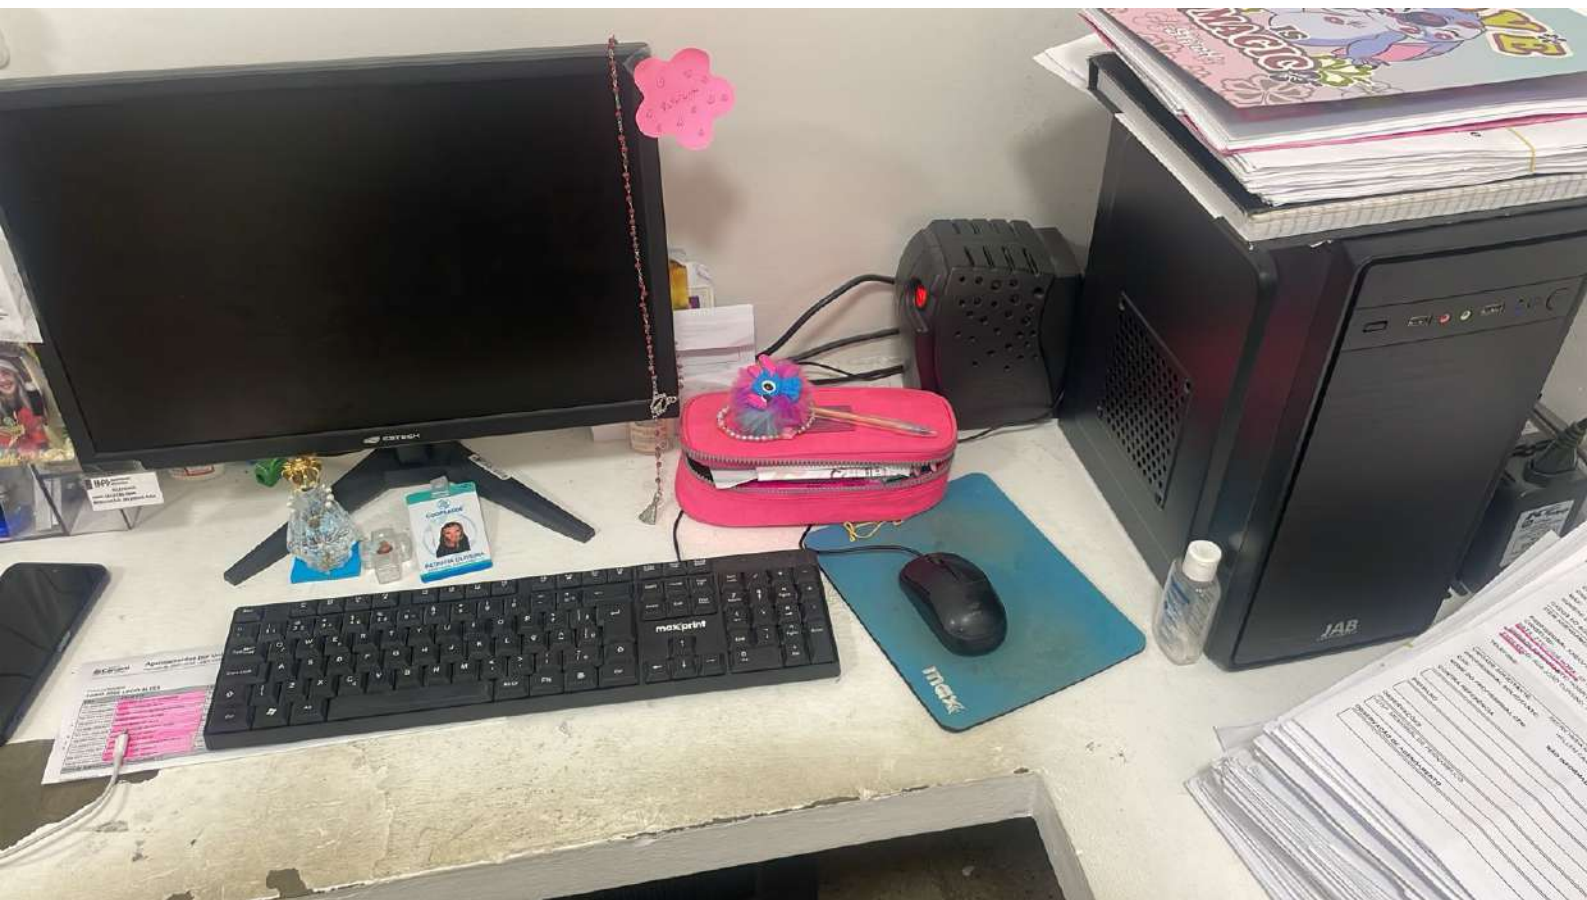

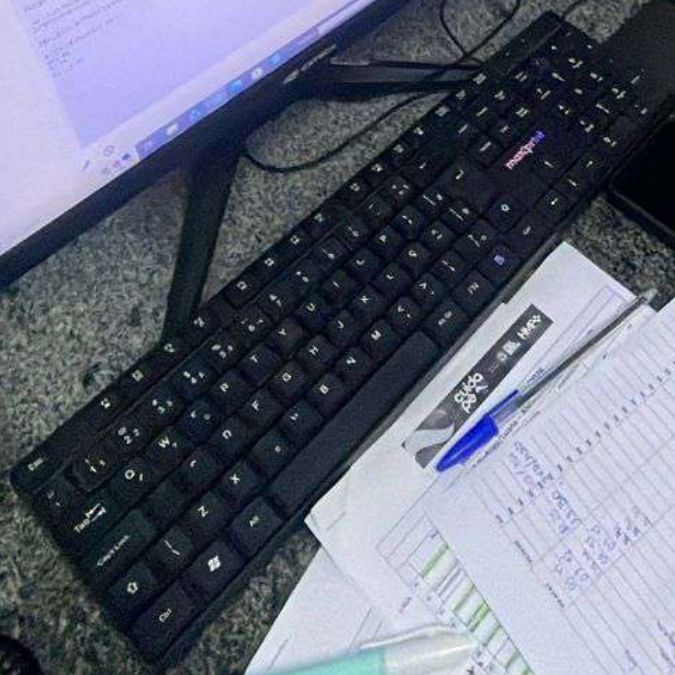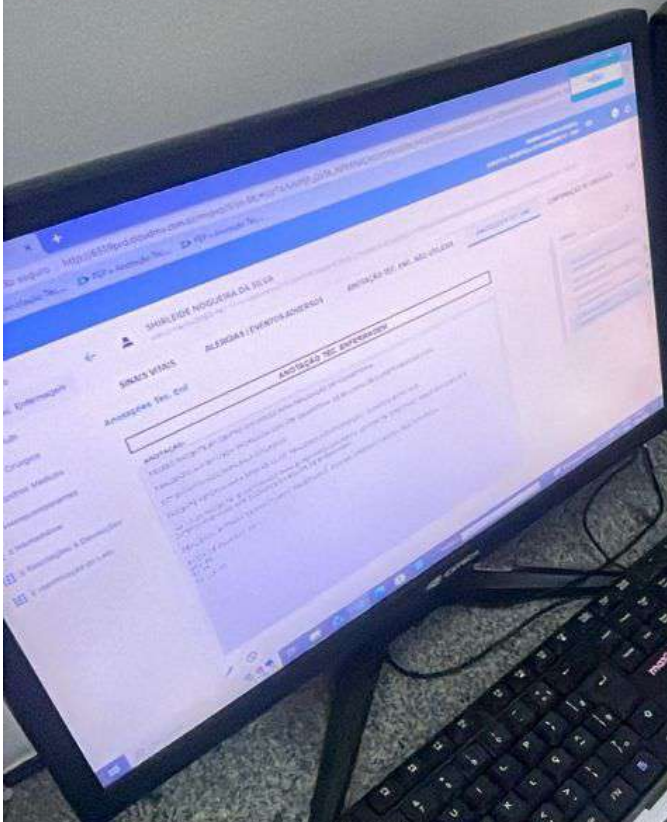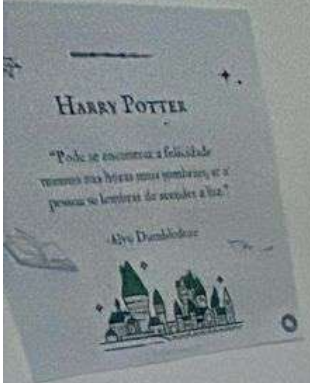

HMP
000892

Modelo: MR-19

Alimentação: 100-240VAC

CATECH

AVISO: Alta tensão! Para evitar choque elétrico, não abra a placa traseira por conta própria! Se precisar de alguma inspeção, entre em contato com profissionais ou assistência autorizada!

MONITOR LED 19 POL. MR-19 CATECH

11243131405301000593

FCCE
INDÚSTRIA BRASILEIRA

C3TECH

Modelo: MR-19
Alimentação: 100-240VAC

AVISO: Alta tensão! Para evitar choque elétrico, não abra a placa traseira por conta própria! Se precisar de alguma inspeção, entre em contato com profissionais ou assistência autorizada!

MONITOR LED 19" POL. MR-19 C3TECH

11243131405301000594

CE **FC** **INDUSTRIA BRASILEIRA**

HMP Hospital de Referência em Patologia Molecular

000891



Modelo: MR-19

C3TECH

Alimentação: 100-240VAC



AVISO: Alta tensão! Para evitar choque elétrico, não abra a placa traseira por conta própria! Se precisar de alguma inspeção, entre em contato com profissionais ou assistência autorizada!



MONITOR LED 19" POL. MR-19 C3TECH
11243131405301000753

FC CE
INDUSTRIA BRASILEIRA

HMP
000889



